EVOOCH

取扱説明書

EVH-BD01
コンパクトボディリフト

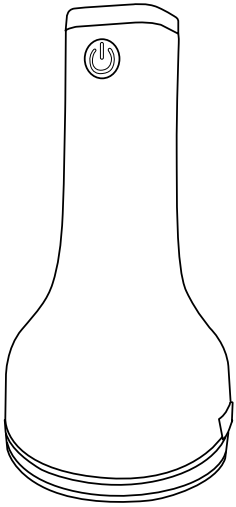

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、
誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよく
お読みのうえ、正しくお使いください。

目次

▶ はじめに

目次 …… 1～2ページ

各部名称 …… 3ページ

安全上のご注意 …… 4～14ページ

▶ 使い方・お手入れ

ご使用前の準備 …… 15～16ページ

操作方法 …… 17～18ページ

ご使用前のプレテスト …… 19～21ページ

ご使用方法 …… 22～23ページ

よくあるご質問 …… 24～25ページ

目次

▶ 使い方・お手入れ

日常の点検・お手入れ …… 26ページ

保管のしかた …… 27ページ

▶ 困ったときは

故障かな？ …… 28～30ページ

アフター販売 …… 31ページ

アフターサービス …… 32～33ページ

カスタマーサポートセンター …… 34ページ

仕様 …… 35ページ

各部名称

目次へ↑

▶ 本体

電源ボタン

背面

ディスプレイ

マイクロUSB端子差込口

充電ランプ

背面

底面

シリコン
ヘッド

合わせ位置

カバー

電極面

▶ 付属品

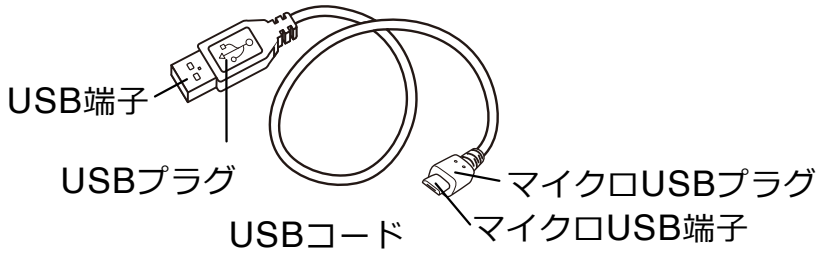

安全上のご注意

目次へ↑

必ずお守りください　本製品は家庭用です。

Li-ion

警⚠告

リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。

⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

安全上のご注意

●下記の医療用電子機器を使用している方は使用しないでください。

・ペースメーカー等の体内埋め込み型医療用電子機器

・心電計等の装着型医療用電子機器

・人工肺等の生命維持用医療用電子機器

●下記に該当する方は使用しないでください。

・肌に関する事項で医師の治療を受けている

・小さなお子様・飲酒後・皮膚感覚が鈍い

・急性疾患、結核性疾患、高血圧、伝染病疾患、悪性疾患、内臓疾患、糖尿病、心臓疾患、出血性疾患のいずれかに該当する

・皮膚病、アトピー性皮膚炎、敏感肌または肌が弱い、皮膚トラブルがある、アレルギー体質のいずれかに該当する

・発熱している、疲労している、体調がすぐれない

・物理的刺激等による病的なシミがある

・生理中、妊娠中、授乳中のいずれかに該当する

・ステロイド等の薬を継続的に使用している

・肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている

・除毛や脱毛をした当日

・日焼け直後、またピーリング直後

・自分で意思表示ができない

安全上のご注意

⚠ 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解・改造・修理を行わないでください。

改造禁止

発火したり、異常動作したりして怪我をするおそれがあります。

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。

禁止

やけど・部品を誤飲するおそれがあります。

USBコードを傷つけないでください。

強制

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせたりすると破損して、火災・感電の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 警告

お手入れは必ずUSBプラグを抜いてから行ってください。

強制

感電や怪我をするおそれがあります。

定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。

強制

ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。

強制

ホコリや汚れの付着または、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBコードが溶けたり変形したりして感電や火災の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 警告

USBプラグを抜くときは、USBコードを持たずに必ず先端のUSBプラグを持って抜いてください。

強制

感電やショートの原因となります。

高温になる場所での充電はしないでください。

禁止

ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。

液漏れしたら火気から遠ざけてください。

強制

リチウムイオン電池が液漏れしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂、発火する原因となります。

安全上のご注意

⚠ 警告

同一箇所への連続使用はしないでください。

禁止

やけど、怪我の原因となります。

本来の使用目的以外に使用しないでください。

禁止

事故や故障の原因となります。

充電する際は付属のUSBコードをご使用ください。

強制

付属以外のUSBコードをご使用されると、火災・感電の原因となります。

濡れた手でUSBプラグを抜き差ししないでください。

禁止

感電して怪我をするおそれがあります。

安全上のご注意

⚠ 警告

USB接続式ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力5V1A以上のACアダプターをご使用ください。

強制

製品の定格入力5V1A以下のUSB接続式ACアダプターをご使用されると、USB接続式ACアダプターの故障の原因となります。

長期間使用しない時は、必ずUSBプラグを抜いてください。

強制

絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。

付属のUSBコードが傷んでいる、または差し込みが緩いときは使用しないでください。

禁止

感電やショートの原因となります。

安全上のご注意

⚠ 警告

異常に気づいたら使用を中止してください。

強制

異臭・発熱・変色・変形・その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱・破裂・発火する原因となります。

ご使用時は45℃以下の環境でご使用ください。

強制

発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。

浴室など湿気の多い場所で使用しないでください。

禁止

感電や故障の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 注意

肌に異常がある箇所に使用しないでください。

禁止

傷等の悪化の原因となります。

本体を火中に投じないでください。

禁止

破裂して怪我をするおそれがあります。

本体に強い衝撃を加えないでください。

禁止

高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。故障の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 注意

本製品は45℃未満の場所で保管してください。

強制

リチウムイオン電池の性能劣化の原因となります。

直射日光が当たる所に置かないでください。

禁止

リチウムイオン電池の性能劣化、液漏れ、発熱、発火などの原因となります。

炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。

禁止

液漏れ、発熱、発火などの原因となります。

安全上のご注意

⚠ 注意

使用中に気分が悪くなったり、肌に異常を感じた場合、使用を中止してください。

強制

肌トラブルとなる恐れがあります。

アクセサリー等の金属を外して使用してください。

強制

怪我のおそれがあります。

使用前に必ずプレテストを行い、使用した箇所の肌状態を確認してください。

強制

肌トラブルとなる恐れがあります。異常を感じた場合は使用しないでください。

お子様や体の不自由な方だけで使用しないでください。

禁止

怪我のおそれがあります。

ご使用前の準備

目次へ↑

▶使用可能箇所

下記の使用可能箇所を確認のうえご使用ください。

- 二の腕
- お腹
- ヒップ、太もも
- ふくらはぎ

禁止

首から上、へその真上、関節部分には使用しないでください。

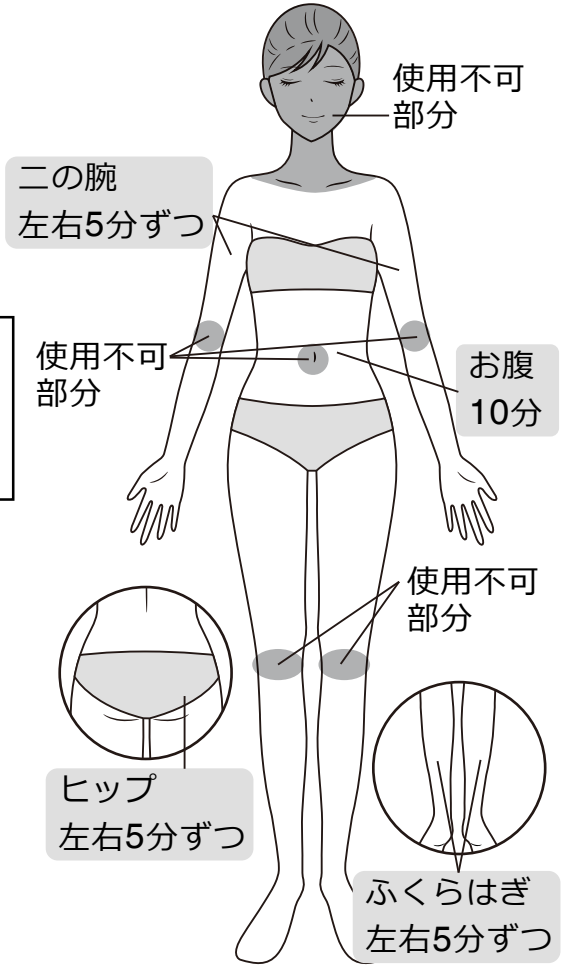

ご使用前の準備

目次へ↑

▶充電方法

・USBコードのマイクロUSB端子を本体のUSB端子差込口に差し込み、反対側のUSBプラグをお持ちの5V1A以上が出力できるアダプターに差し込みます。
・充電中、充電ランプが赤色に点灯します。充電ランプが消灯したら充電完了です。
・充電時間は約2.5時間です。
・充電中は動作しません。
・長期間使用しなかった場合、または購入したばかりの場合は、まず充電をしてください。
・充電が完了したら、USBケーブルを抜いてください。
・満充電時の合計使用可能時間は約5.5時間（バイブレーションモード時）です。

▶使用環境

・周辺温度が0～45℃の環境でご使用ください。

操作方法

目次へ↑

▶モード

①Vibration（バイブレーションモード）

・シリコンヘッドが赤色に点灯し、振動します。



②Rhythm（リズムモード）

・シリコンヘッドが赤色に点滅し、振動します（短い振動２回＋長い振動１回の繰り返し）。シリコンヘッドが約45℃になります。



③EMS（EMS弱モード）

・シリコンヘッドが赤色に点滅し、EMS（弱）により筋肉に電気刺激を与えます。



④EMS（EMS強モード）

・シリコンヘッドが赤色に点滅し、EMS（強）により筋肉に電気刺激を与えます。シリコンヘッドが約45℃になります。



※各モードの開始後、10分経つと自動的に電源がオフになります。

操作方法

▶使用方法

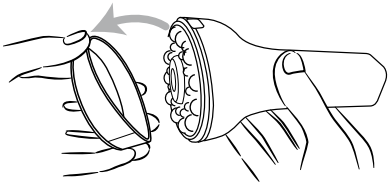

・カバーを取り外します。

・電源ボタン⏻を1回押すと、
「ピー」という音が鳴り
バイブレーションモードで起動します。



▶モードの変更

・動作中に電源ボタン⏻を押すと、モードが変わります。

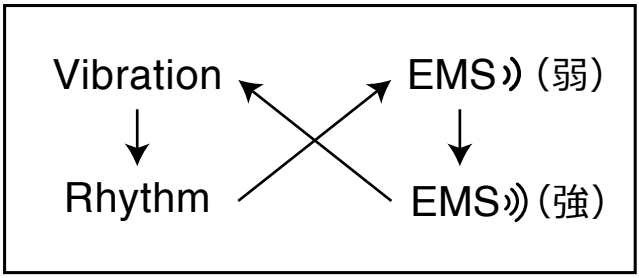

▶終了方法

・電源ボタン⏻を2秒以上長押ししてください。

ご使用前のプレテスト

目次へ↑

▶肌へのプレテスト

初めて本製品を使う際は、ご使用になる前に必ず肌へのプレテストを実施してください。

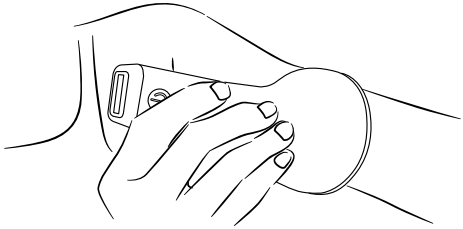

1.腕の内側を洗浄し、清潔な状態にしてください。その後タオル等で水分を拭き取ってください。

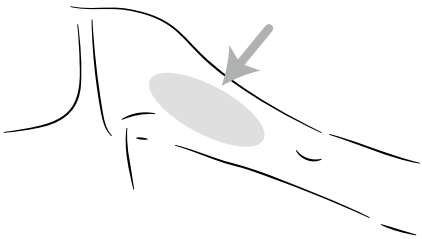

2.洗浄した部分に化粧水等を塗ってください。

3.電源ボタン⏻を1回押して、起動させてください。

4.電源ボタン⏻を2回押しEMS))（EMS弱モード）に設定します。



ご使用前のプレテスト

5.化粧水等を塗った部分に本体の電極面を当て、約3分間上下になぞるように動かしてください。※同じ部分にシリコンヘッドを当て続けないでください。※プレテスト実施中は本製品を絶えず滑らせて動かし続けてください。※お手持ちのタイマー等で、3分間計ってください。※EMSのモードはEMS))（EMS弱モード）で行ってください。

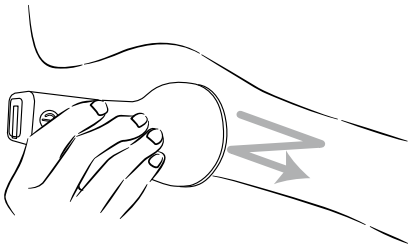

6.終了後、本体を肌から離し、電源ボタン⏻を2秒以上長押しして電源を切ってください。※プレテスト実施中に肌に異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。



ご使用前のプレテスト

プレテストから24時間以内に次の症状が現れた場合、本製品の使用はしないでください。

- **肌に赤みが出ていませんか？**
- **肌が腫れていませんか？**
- **水泡ができていませんか？**
- **痛みを感じていませんか？**
- **引きつりを感じていませんか？**
- **かゆみは出ていませんか？**

1つでも項目に当てはまる場合は、本製品の使用はしないでください。その他、肌に異常を感じた場合も使用を中止してください。ご自身で判断できない場合、医師にご相談ください。

ご使用方法

目次へ↑

▶ボディに使用するおすすめの使い方

腕の内側を洗浄し、清潔な状態にしてください。タオル等で水分を拭き取り、洗浄した部分に化粧水等を塗ってください。その後お好みのモードで起動し、ご使用ください。

●二の腕（左右5分ずつ）

1.手のひらを上にし、腕をまっすぐ伸ばしてください。
2.ひじから脇に向かって本製品を滑らせます。二の腕の内側と外側両方に行ってください。
3.反対側の腕も行ってください。

※関節部は避けてください。

●お腹（1で5分、2+3で5分）

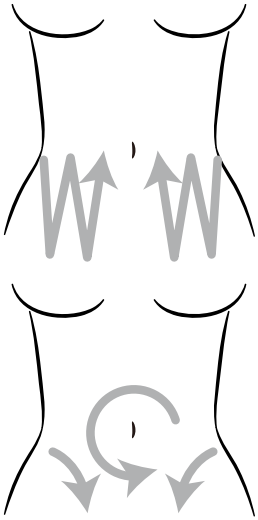

1.お腹の外側から内側へ向かって上下に滑らせます。滑らせる部分を少しずつ脇腹からおへそに向かって移していきます。
2.脇腹から足の付け根に向かって滑らせます。
3.へそを中心に大きな円を描くように滑らせます。

※へその真上は避けてください。

ご使用方法

●太もも（左右5分ずつ）

1.太ももの内側部分をひざから足の付け根に向かって滑らせてください。

2.太ももの裏側をひざから足の付け根に向かって滑らせてください。

3.反対の太ももも行ってください。

※関節部は避けてください。





●ヒップ（1で5分、2+3で5分）

1.お尻の内側から外側に向かって上下に滑らせてください。滑らせる部分を少しずつ外側に移していきます。

2.内側から外側に向かって円を描くように滑らせてください。

3.中心部は太ももの付け根に向かって上から下に滑らせてください。





よくあるご質問

目次へ↑

●使用できない箇所はありますか？

あります。使用可能箇所（P15）をご確認ください。

●敏感肌にも使用可能ですか？

肌へのプレテスト（P19～P21）を実施してください。肌に異常がなければご使用いただけます。肌に異常を感じた場合、すぐに使用を中止し、ご自身で判断できない場合は医師にご相談ください。

●お風呂で使用可能ですか？

本体は防水仕様ではありません。浴室など本体に水やお湯がかかるおそれがある場所では使用しないでください。感電や発火の原因となります。

よくあるご質問

●化粧水等の使用量はどれくらいですか？

肌の表面が十分に湿った状態になる量をご使用ください。肌が乾いた状態では、EMSが肌に伝わりにくくなり痛みを感じたり、シリコンヘッドが滑りにくくなったりします。使用中に効果が感じられなくなったり、滑りが悪くなったりした場合は、化粧水等を塗り足してください。

●毎日使用できますか？

週2～3回を目安にご使用ください。

日常の点検・お手入れ

目次へ↑

必ず電源を切った状態で行ってください。

1.表面についた化粧水等を乾いた柔らかい布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れを拭き取ってください。

※アルカリ性の洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液は使用しないでください。

2.表面についた水分等を拭き取ってください。

3.シリコンヘッドについた水分や化粧水等を拭き取ってください。表面と同様にお手入れをしてください。

4.直射日光の当たらない風通しの良い場所で乾かしてください。

保管のしかた

目次へ↑

・使用後はカバーを付けて保管してください。
・長期間使用しないときは、本体のお手入れ及び充電をしてから保管してください。
・1ヵ月に1回は充電してください。
・子供の手の届かない場所に保管してください。
・ストーブなど火気が近い場所、浴室等高温多湿の場所、車の中、直射日光が当たるなど高温になる場所、高所、不安定な場所等を避けて保管してください。
・保管時は、周辺温度が0～45℃の環境で保管してください。

故障かな？

目次へ↑

充電ができない	
原因	定格出力が5V1A未満のＵＳＢ接続式ＡＣアダプターを使用していない
対処方法	定格出力が５V1A以上のUSB接続式ACアダプターをご使用ください。

EMSの電気刺激が感じられない、弱い	
原因	肌の表面が乾燥している、または水分が足りていない。
対処方法	化粧水等を塗り足し十分に湿らせてください。
原因	EMSの出力レベルが低い。
対処方法	モードをEMS))(EMS強モード)にしてください。
原因	肌に電極面が密着していない。
対処方法	肌にぴったりと電極面を当ててください。

故障かな？

EMSの電気刺激が強く感じる、痛い	
原因	肌に電極面が密着していない。
対処方法	肌にぴったりと電極面を当ててください。
原因	EMSの出力レベルが高い。
対処方法	モードをEMS))（EMS弱モード）にしてください。

使用中肌が赤くなる	
原因	同じ箇所に当て続けている。
対処方法	シリコンヘッドを同じ箇所に当て続けないでください。必ず肌の上を滑らせるように動かし、赤みが強いときはすぐに使用を中止してください。

故障かな？

使用中肌が熱くなりすぎる	
原因	同じ箇所に当て続けている。
対処方法	シリコンヘッドを同じ箇所に当て続けないでください。必ず肌の上を滑らせるように動かし、熱さが強いときはすぐに使用を中止してください。

使用中に電源が切れた	
原因	充電がなくなった。
対処方法	充電してください。
原因	10分以上使用した。
対処方法	オートオフ機能で停止しています。再度電源ボタンを押して起動してください。

アフター販売

目次へ↑



USBコード
CS-K579
660円(税込)

アフターサービス

目次へ↑

▶保証について

商品の品質には万全を期しておりますが、万一商品が破損・汚損していた場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取り替えさせていただきます。

補修用性能部品の生産終了後の保有期間は5年です。

その他ご不明点がございましたら下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

アフターサービス

▶ 消耗品・部品のご注文

オフィシャルサイトにて消耗品
及び部品のご注文を承っております。

lifeonproducts-online.com

※オフィシャルサイトにてお取り扱いの無い消耗品及び
部品に関しましては、メールにてお問い合わせください。

▶ お問い合わせ

メールにてお問い合わせを24時間受け付けて
おります。17時以降のお問い合わせに関しましては、
翌営業日中に返答をさせていただきます。
下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせ
をお願いいたします。

lifeonproducts.co.jp/contact/form2

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目を
ご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日
■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

カスタマーサポートセンター

目次へ↑

ライフオンプロダクツ株式会社

＜カスタマーサポートセンター＞

〒550-0015

大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

仕様

目次へ↑

品番	EVH-BD01
電源	DC5V/0.6A
消費電力	3W
充電電池	リチウムイオン電池 3.7V950mAh
充電時間（約）	2.5時間
満充電時の合計使用可能時間（約）	5.5時間（バイブレーションモード時）
電源コード（約）	USBコード：560mm
モード切替	4種類(バイブレーション/リズム/EMS弱/EMS強）
オートオフ（約）	10分
防水性能	IPX5（先端部分のみ）
本体サイズ（約）	82×81×138mm
本体重量（約）	163g
セット内容	本体、カバー（本体装着済）、USBコード、クイックスタートガイド、保証書

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。